

### 시작하기 전에

- 이 검사 키트는 상온에 또는 어디든 2~30°C 사이의 장소에 두세요(냉동고에 보관하지 마시고 햇빛이 직접 닿지 않게 하세요. 차 안에 두지 마세요).
- 흘릴 경우 청소하기 쉬운 깨끗하고 평평한 표면(음식, 음료, 잡동사니가 없는)을 찾습니다.
- 검사 중 먹거나, 마시거나, (전자) 담배를 피우거나, 콘택트렌즈를 착용하거나, 화장을 하거나, 얼굴을 만지지 마세요.
- 이 검사 키트는 자가 검사용입니다.
- 코피가 나면 이 검사 키트를 사용하지 마세요.

### 도움이 되는 정보

신속 검사에 관한 추가 정보, 이 설명서의 번역본, 검사 수행 방법 안내 동영상 등을 보시려면 아래 QR 코드를 스캔하거나 [bccdc.ca/covid19rapidtesting](https://bccdc.ca/covid19rapidtesting)을 보세요.



- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ལྷན་སྐད་
- français
- 한국어
- عربي
- فارسی
- 

### 검사의 정확도에 대한 이해

신속 항원 검사로는 COVID-19 유발 바이러스의 항원(단백질)을 탐지합니다. 이 검사로 바이러스가 충분히 검출될 정도가 되려면 감염 후 **3~7일**이 지나야 할 수 있습니다. COVID-19에 걸린 사람이 감염된 후 너무 일찍 검사를 하면 검사 결과가 음성으로 나올 수 있습니다. 이를 거짓 음성이라고 합니다.

신속 항원 선별 검사로는 한 시점의 결과만 나타냅니다. 결과가 음성이라고 해서 전염성이 없다고 보장하지는 않습니다. 최근 COVID-19에 노출된 적이 있고 나중에 검사를 할 때 몸에 항원이 검출될 만큼 있으면 결과가 여전히 양성으로 나올 수 있습니다.

### 검사 방법


- 1** 코를 풀고 휴지를 버립니다. 손을 비누로 씻습니다.



- 2** 검사 장비를 펼쳐 놓습니다.

- Artron 검사 키트
- 검사기 1개
- 살균 면봉 1개
- 시험관(밀봉된 액체) 1개
- 시험관 뚜껑 1개
- 시험관 받침대 1개(제공된 경우)

- 타이머
- 쓰레기통
- 작은 유리잔 또는 컵(선택 사항)

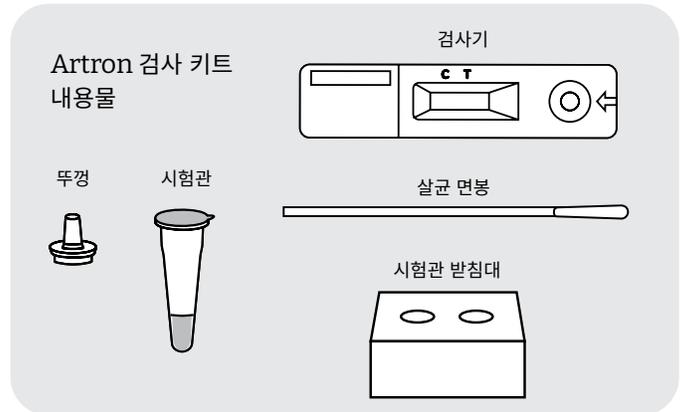

타이머




쓰레기통




작은 유리잔 또는 컵  
(선택 사항)

- 3** 시험관에서 은박지를 벗겨냅니다.




- 4** 시약이 든 시험관을 조립한 시험관 받침대 또는 깨끗한 유리잔이나 컵 안에 놓습니다.

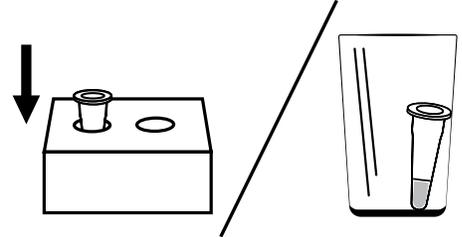


- 5** 코에서 검체를 채취합니다.


- 1 면봉을 포장에서 꺼냅니다. 플라스틱 손잡이만 만지세요.
- 2 고개를 뒤로 젖힙니다.
- 3 면봉 끝을 한쪽 콧구멍에 넣고 (위쪽이 아닌) 코 뒤쪽으로 똑바로 1.5cm(3/4인치) 집어넣습니다.
- 4 면봉을 코 안쪽에 대어 코안의 액체를 채취합니다. 부드럽게 천천히 5회 돌립니다.
- 5 같은 면봉으로 다른 쪽 콧구멍에서 반복합니다.

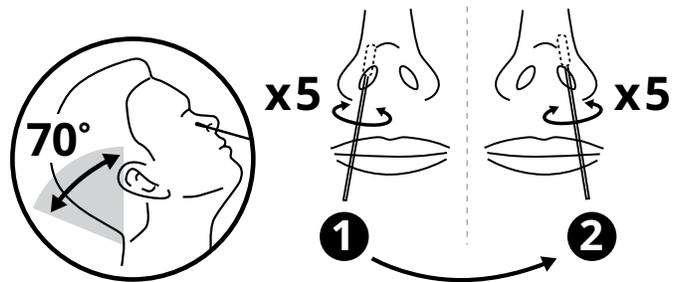


면봉에 피가 묻어 있으면 검사용으로 사용하지 마세요. 코를 풀고 새 면봉을 사용하세요. 코피가 났으면 24시간 기다린 다음에 검사하세요.



- 6** 면봉 끝을 시험관에 살살 넣습니다.



- 1** 면봉 끝을 시약 안에 넣고 부드럽게 천천히 10회 휘젓습니다.




- 2** 시험관 양옆에서 면봉 끝을 꼭 집어 시약을 다 짜내고 면봉을 꺼냅니다. 면봉을 쓰레기통에 버립니다.




- 3** 뚜껑을 시험관에 단단히 눌러 닫아 밀봉합니다.

**7** 검사기를 개봉하고 평평한 표면(예: 테이블)에 놓습니다.




**8** 시험관을 검사기 바로 위에서 들고 뚜껑이 똑바로 아래를 향하게 합니다. 천천히 4방울을 짜내 검사기의 원 위로 떨어뜨립니다.


시험관이 원에 닿지 않게 하세요.




**9** 타이머를 30분으로 맞추고 결과를 기다립니다. 이 시간 중에는 검사기를 움직이지 마세요. 30분이 지나면 측정값이 정확하지 않을 수 있습니다.



**10** 모든 검사 장비를 쓰레기통에 버립니다.

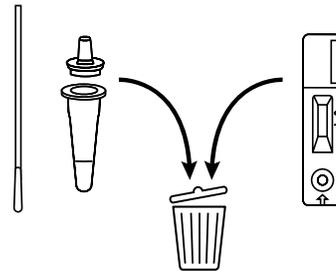

**11** 손을 씻습니다.




### 결과를 읽는 방법

어느 선이 먼저 나타났는지 또는 선들이 얼마나 희미하게 보이는지는 중요하지 않습니다. 선들은 분홍색이나 보라색일 것입니다. 타이머를 맞추고 나서 검사기를 모니터하세요. 검사 결과는 최대 30분이 걸릴 수 있습니다. 양성 결과는 더 빨리 나타날 수 있습니다.

**검사 결과가 양성이든 음성이든 의료가 필요하다고 생각되면 받으세요.**

#### 음성 결과


대조선(C)만 나타납니다.



결과가 음성이면 COVID-19가 감지되지 않았다는 뜻입니다. COVID-19가 있을 가능성이 여전히 있습니다.

#### 양성 결과

대조선(C)과 검사선(T)이 나타납니다.

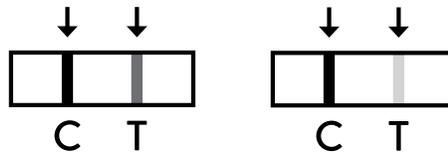


양성 결과는 COVID-19에 걸렸을 가능성이 있으며, 다른 사람들에게 옮길 수 있다는 뜻입니다.

치료가 도움이 될 수 있는지 [gov.bc.ca/covidtreatments](https://gov.bc.ca/covidtreatments)에서 확인하시거나 1-888-268-4319로 문의하세요

#### 잘못된 결과

대조선(C)이 없습니다.

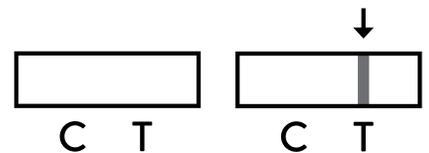

검사가 잘못되면 첫 번째 검사에 쓰인 물품을 전부 버리세요. 손을 씻고 두 번째 검사 물품으로 이 과정을 반복하세요. 검사 방법을 따라 다시 하세요.